



Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A43/A75

< 75 Kg / 165 liber


Posuvný dvojitý adaptér – aluminium

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



Obr. 1

Obr. 2

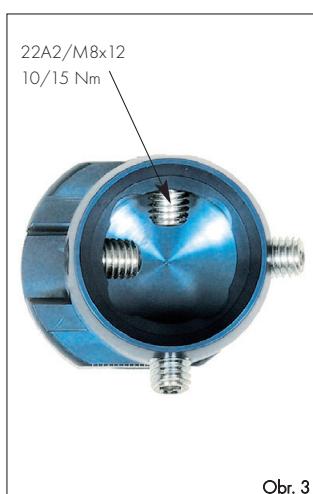

Obr. 3

1. Účel použití

Posuvný adaptér 10A43/A75 se užívá výhradně k protetickému ošetření dolních končetin. Podle klasifikačního systému firmy Streifeneder je doporučován pro pacienty s tělesnou hmotností do 75 kg.

2. Popis

Posuvný adaptér 10A43/A75 představuje spojení mezi dvěma pyramidy a modulární stehenní nebo běrcovou protézou firmy Streifeneder. Vedle funkce jako dvojitý adaptér (jako 10A50) jsou možné další translační nastavení lůžka protézy (Obr.1 a 2).

3. Manipulace se stavěcími šrouby

Pomocí čtyř stavěcích šroubů 22A2/M8x12 je možno přehledně provádět statické korektury kdykoli během konstrukce, při zkoušce, ale i po dokončení protézy. Při výměně jednoho modulu nebo při demontáži je původně nastavená pozice ponechána, jsou-li vyšroubovány pouze dva vedle sebe se nacházející šrouby, a sice ty původně nejvíce zašroubované (Obr. 3).

Pozor!

Při utahování šroubů 22A2/M8x12 dodržujte následující postup:

Nejprve rovnoměrně přitáhněte šrouby momentovým klíčem 173P11 silou 10 Nm. Při dokončování protézy je zajistěte pomocí Loctite 118P35 a jeden po druhém utáhněte na 15 Nm.

4. Nastavení posudu

Translační nastavení je možno alternativně provádět ve frontální a sagitální rovině. Horní část adaptéra lze po rybinovém vedení posunout asi o 9 mm a pak fixovat šrouby 22A2/M6x30 (Obr.2).

Použijte momentový klíč 173P11. Dotahovací moment 15 Nm.

Při dokončování protézy zajistěte šrouby pomocí Loctite 118P35.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, jestli výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že posuvný adaptér 10A43/A75 odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.